Aanbrengtechnieken voor een gipsverband

exogen®
Ultrasoon botgenezingssysteem

Neem voor bestelling van sets voor gipsverbanden contact op met uw productspecialist van EXOGEN

Aanbrengen in gipsverband met vierkant kussentje

- Lokaliseer de plaats van de fractuur aan de hand van röntgenfoto's
- Markeer op het gipsverband het te behandelen gebied met een X

- Gebruik een standaard gipszaag
- Zaag een venster uit het gipsverband

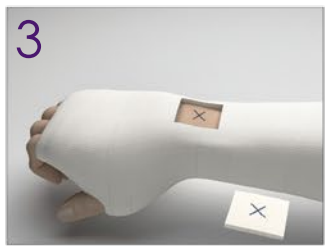

- Verwijder het nieuw gevormde venster
- Verwijder het teveel aan zacht vulmateriaal en knip de kous in met een schaar

- Verwijder lagen van het vierkante vilten kussentje tot het even dik is als het gipsverband
- Gebruik het vierkante kussentje uitsluitend wanneer een vierkante opening wordt uitgezaagd

- Plaats de RAF in het gazen matje tot dit het onderste lipje bedekt
- Verwijder de klevende toplaag van het gebroken witte vierkante kussentje en plak het tegen de onderkant van de RAF

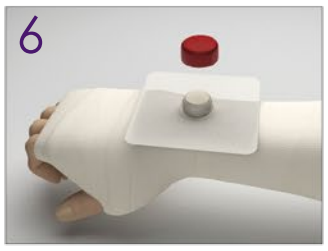

- Plaats de samengevoegde delen in het vierkante venster
- Plaats de rode dop op de RAF

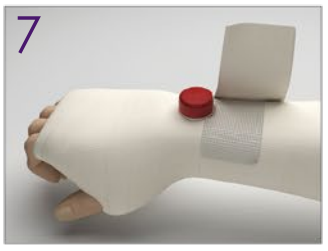

- Rond het aanleggen van het gipsverband af om het gazen matje rond de RAF te bedekken

- Volledig in het gipsverband ingebouwd

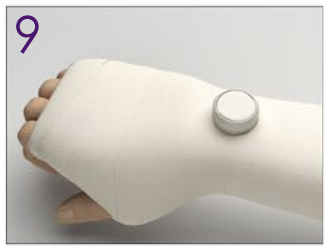

- Breng het vilten afdekrondje aan om oedeemvorming in het venster te voorkomen

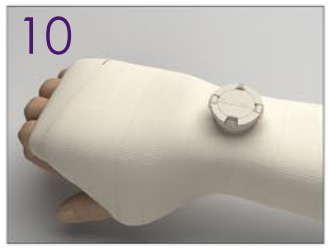

- Plaats de RAF-dop

Ingebouwd in gipsverband

- Markeer het te behandelen gebied en trek de kous aan
- Knip een opening in de kous boven de behandelplaats en zorg ervoor dat het gemarkeerde gebied vrij is tot de huid

- Verwijder de klevende toplaag van het gebroken witte vierkante kussentje en plak het tegen de onderkant van de RAF
- Breng het geheel aan in de kous

- Afbeelding van correcte plaatsing onder het vulmateriaal

- Plaats het vilten afdekrondje om de RAF op zijn plaats te houden

- Breng een viltstrook aan over het gipsverband – splijt of knip een opening die over de RAF past
- Breng de rest van het vulmateriaal van het gipsverband aan. Door de RAF door de opening te duwen blijft deze beter op zijn plaats wanneer het aanleggen van het gipsverband wordt voltooid.

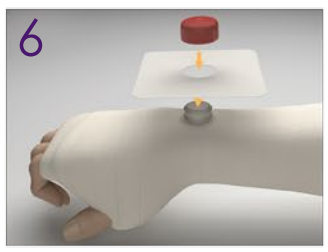

- Breng één laag synthetisch gipsmateriaal aan
- Plaats een vierkant gazen matje op de kunststof poort voor een stevige constructie

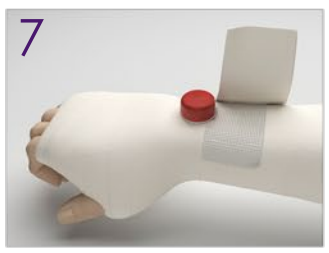

- Plaats de rode dop op de RAF
- Rond het aanleggen van het gipsverband af om het gazen matje rond de RAF te bedekken

- Plaats de RAF-dop

Aanbrengen op gipsverband

- Positioneer het samengevoegde geheel van RAF en riem stevig over het venster in het gipsverband

- Plaats het ronde vilten afdekrondje in de RAF

Accessoireset voor gipsverband

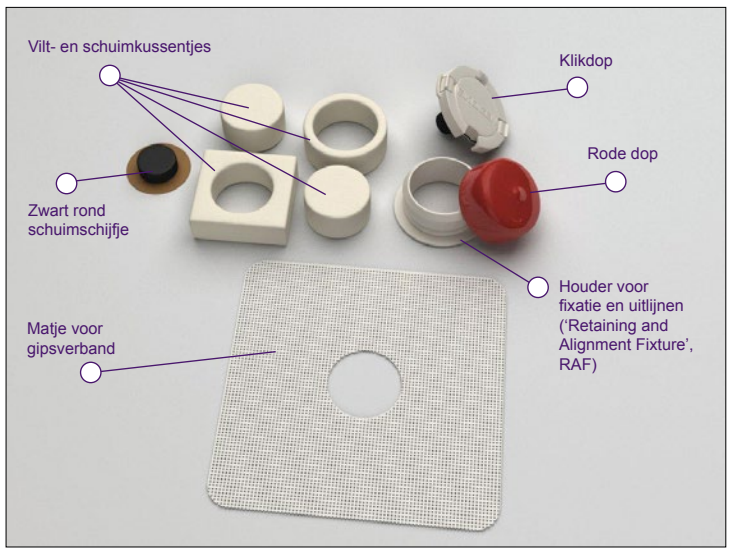

Samenvatting van de gebruiksindicaties

EXOGEN is geïndiceerd voor niet-invasieve behandeling van botdefecten (uitgezonderde de vertebrae en schedel), dit omvat de behandeling van delayed union fracturen, non-union-fracturen†, stressfracturen en arthrodese. EXOGEN is ook geïndiceerd voor de verkorting van de genezingsduur van verse fracturen, de versnelling van reparaties na osteotomie, reparaties bij bottransportprocedures en reparaties bij distractieosteogeneseprocedures.

† Er is sprake van een non-union-fractuur als op de locatie van de fractuur geen enkele progressieve tekenen van heling zichtbaar zijn.

Er zijn geen contra-indicaties bekend voor het EXOGEN-hulpmiddel. De veiligheid en werkzaamheid is niet vastgesteld bij personen waarvan het skelet niet volgroeid is, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, patiënten met pacemakers, voor fracturen als gevolg van botkanker of bij patiënten met een slechte bloedcirculatie of stollingsproblemen. Sommige patiënten kunnen overgevoelig zijn voor de ultrasoon-gel.

De volledige indicatie-informatie vindt u op het productetiket, of op www.exogen.com.

Bioventus Coöperatief U.A.
Taurusavenue 31
2132 LS Hoofddorp
Nederland

Customer Care
T: 0800 0599 (gratis)
E: customercare-international@bioventusglobal.com

www.BioventusGlobal.com
www.exogen.com
EXOGEN en het Bioventus-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bioventus LLC.
© 2015 Bioventus LLC SMK-001453 11/15

bioventus®